



## CONFIGURAZIONE CUFFIA

DATA: Riferimento a Vostro ordine:  
o Nostro preventivo n°:

Nome Ente o Istituzione:

Nome e cognome compilatore in stampatello :

### Supporto:

Tela Colorata elastica  
Neoprene Nero

### sistemazione cavi:

CAVI ESTERNI  
CAVI INTERNI

altro: specificare:

FIRMA \_\_\_\_\_  
e TIMBRO \_\_\_\_\_

CONNESSIONE

CAVO DI CONNESSIONE

PRESA DI SICUREZZA

ATTACCO DIRETTO

2mm PIN

Taglie Standard, per altre taglie tipo Neonatali,  
o misure intermede, visualizzare pagina successiva

TAGLIA:	62-58/BLU	N.....	46-42/AZZURRA	N.....
N=n° pz	58-54/ROSSA	N.....	42-38/ROSA	N.....
	54-50/GIALLA	N.....	38-34/MARRONE	N.....
	50-46/VERDE	N.....	Altro: Circ.	N.....

Riportare N° elettrodi:

Adulto:


Pediatrica:

Neonatale:


### MODELLO EEG

Mod. e produttore

SEGNARE GLI ELETTRODI E LE POSIZIONI RICHIESTE  
FACENDO PARTICOLARE ATTENZIONE  
ALL'ELETTRODO DI RIFERIMENTO (REF)

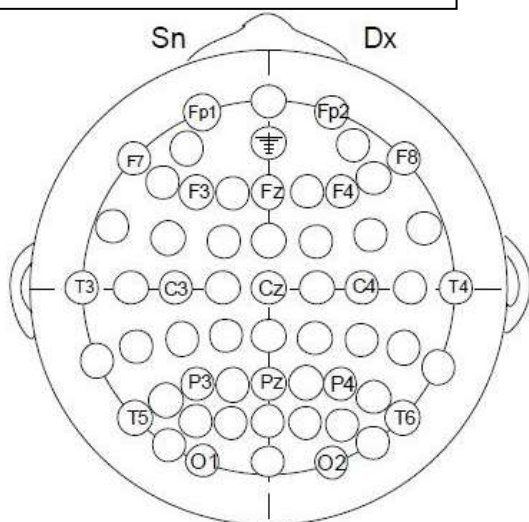

Esempio



### CONNETTORE

Numero pin:

TIPO:

SUBD

25

37

50

MDR

36

50

68

Descrizione:


\_\_\_\_\_

Dopo aver compilato inviare via fax 0521 642193 o info@tecnohealth.it


SEGUE MISURE DISPONIBILI E ALTRO



## MISURE DISPONIBILI

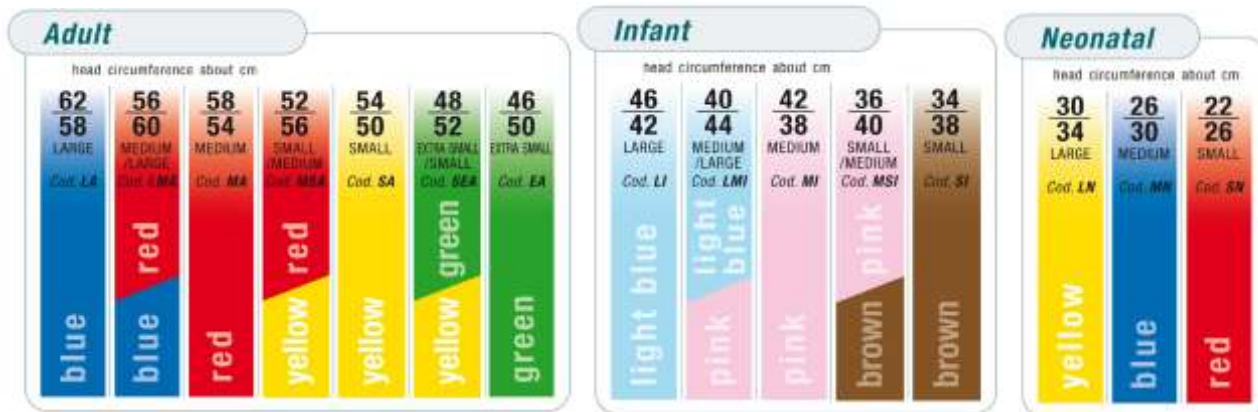

**CONFIGURAZIONE LIBERA POSIZIONE ELETTRODI MAX 64 ELETTRODI**  
SE NECESSARI + DI 64 ELETTRODI SULLA TELA CONTATTATECI.

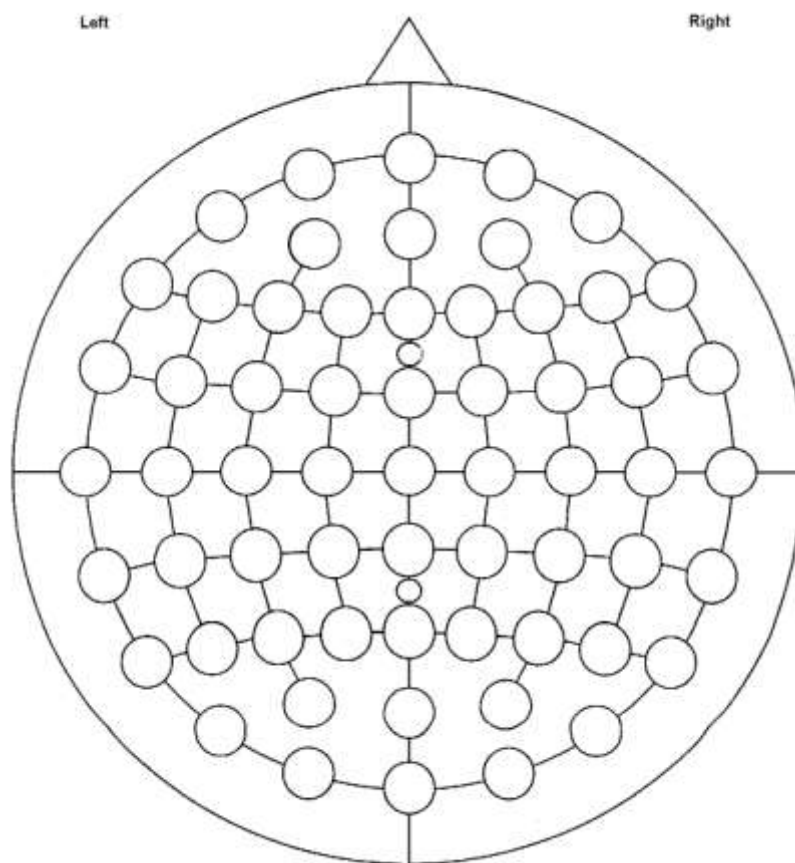



## FACOLTATIVO

NUMERO DI APPARECCHIATURE EEG IN USO :

NUMERO DI APPARECCHIATURE EMG IN USO :

NUMERO DI APPARECCHIATURE IN USO IOM :

### **APPARECCHIATURA/E IN USO SULLA/E QUALI ANDREBBERO UTILIZZATE LE CUFFIE**

Produttore

Modello

Tipologia di connessione utilizzata ATTUALMENTE:

PRESE/SPINOTTI SINGOLI PER OGNI CAVETTO: si no

CONNESSIONE diretta DI UN MULTICONNETTORE ALLA TESTINA EEG

( in QUESTO CASO si richiede invio della tipologia o immagine del CONNETTORE e numero di pin)

Tipologia CONNETTORE:

Numero PIN:

PER INVIO IMMAGINE e modulo compilato:

INVIARE VIA email a [info@tecnohealth.it](mailto:info@tecnohealth.it) oppure fax 0521 642193



### ACCESSORI PER MONITORAGGIO NERVI(IOM):

elettrodi a filo/hook, cork screw, probe/stimolatori, laringei, ad ago subdermici, scalp electrode  
UTILIZZABILI CON TUTTE LE APPARECCHIATURE IN USO: INNOMED, NERVEANA NEUROVISION, AVALANCHE DR. LANGER, NIM 2 NIM 3 MEDTRONIC, NEURSIGN MAGSTIM,



### EEG EMG EP , SONNO POLISONNOGRAFIA:

PER UTILIZZO CON KEYPOINT NATUS, MICROMED, MEDELEC NATUS, VIASYS, NICOLET NATUS, EB NEURO, EMBLA, EMBLETTA, COPUMEDICS, RESPIRONICS, NIHON KOHDEN, GRASS, ALTRI



Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici:

TecnoHealth s.r.l.  
Via R. Koch, 61/A - 43123 Pilastrello (PR)  
Tel. +39 0521 346880 - Fax +39 0521 642193  
[info@tecnohealth.it](mailto:info@tecnohealth.it) - [www.tecnohealth.it](http://www.tecnohealth.it)